


Certificate of Analysis

Analysis No	124-2026	Article No.	MgCl.PURE.P
Article	Chlorek magnezu sześciowodny	Batch Number	25-023303
Expiration Date	10.09.2028	Shipment Date	30.01.2026
Test Date	30.01.2026	Validation Date	12.02.2026
Validation Result	Conform	Approved By	Head of Laboratory

Test Unit	Value	Specifications	Unit	Methods
FIZCH				
Zawartość wilgoci (MOIST)	17.93	≤ 55	%	SOP.A.FIZCH.MOIST&ASH
Zawartość popiołu (ASH)	24.43	≤ 40	%	SOP.A.FIZCH.MOIST&ASH
Aktywność wody (AW)	0.22	≤ 0.6	-	SOP.A.FIZCH.AW
FTIR				
Tożsamość - identyfikacja FTIR (ID)	potwierdzona - widmo zgodne	potwierdzona - widmo zgodne	-	SOP.A.FTIR.ID
AAS.HeavyMetals				
Zawartość ołowiu (Pb)	0.50	≤ 3	ppm	SOP.A.AAS.HeavyMetals
Zawartość kadmu (Cd)	0.18	≤ 1	ppm	SOP.A.AAS.HeavyMetals
ORGLEP				
Postać	krystaliczny proszek	krystaliczny proszek, bezpostaciowy proszek	-	SOP.A.ORGLEP
Barwa	biała	charakterystyczny a, biała, żółta	-	SOP.A.ORGLEP
Zapach	charakterystyczny	charakterystyczny, bezwonny	-	SOP.A.ORGLEP
MICRO				
Obecność Salmonella spp.	Nie wykryto w 25g	Nie wykryto w 25g	-	SOP.A.MICRO
Ogólna liczba pleśni i drożdży (grzybów)	<100	≤ 1000	CFU/g	SOP.A.MICRO

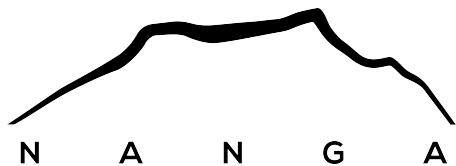

NANGA Przemysł Figura
Piłska 24
77-400 Błękwi

Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych	<100	≤ 10000	CFU/g	SOP.A.MICRO
Liczba bakterii z grupy Enterobacteriaceae	<10	≤ 100	CFU/g	SOP.A.MICRO
Liczba bakterii E. coli	<100	≤ 100	CFU/g	SOP.A.MICRO
Liczba bakterii S.aureus	<100	≤ 1000	CFU/g	SOP.A.MICRO

K. Piłbarch

Approved: Head of Laboratory
Błękwi, 12. Februar 2026